

期間限定 特別価格で提供します

OpenLab CDS 2 アップグレードキャンペーン



今がチャンス！ 2024年(令和6年)10月31日まで OpenLab CDS 2 アップグレードキャンペーン

ラボの分析結果のデータ管理は、印刷された紙の記録から電子的なデータへと大きく様変わりしています。その他にも、データを異なるシステムへと共有するDX改革、医薬品GLP/GMPのデータインテグリティ規制やISO/IEC 17025など分析結果への信頼性担保、働き方の多様化と業務効率化との両立にも対応しなければなりません。このような課題を解決する機能を持ったOpenLab CDS 2にアップグレードしませんか？

OpenLab CDS 2 にアップグレードして ラボを最新の状態で維持しましょう

現在、ChemStation や EZChrom を使用しているのであれば、OpenLab CDS 2 はラボの生産性を向上させるための標準的なデータシステムとなることでしょう。

- 革新的で直感的なインターフェースで操作性を向上
- アジレントの装置だけでなく、ウォータースや島津製作所など他社のGCやLCも制御可能
- 異なる視点でデータを評価できるピークエクスプローラ
- 高い知名度：諸外国の規制当局査察官にも規制対応ソフトウェアとして認知
- データインテグリティ対応：監査証跡レビュー、バージョン管理、電子署名、アクセスコントロールなど
- 高い拡張性：スタンドアロンからネットワークシステムへの拡張はいつでも可能
- 簡単でありながら自由度の高いレポートを作成できるインテリジェントレポート
- 単純なクリック操作で積分パラメータを設定できる積分最適化ウィザード機能が新たに搭載

Agilent
OpenLab



今だけの特別価格

50% OFF!!

期間：2024年10月31日まで

対象：

OpenLab ChemStation または EZChrom を現在お使いの方で、OpenLab CDS 2 にアップグレードする場合。

(M8411AA、M8414AA、M8415AA、M8416AA)。

本資料掲載の製品は、すべて研究用です。本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。アジレントは、本文書に誤りが発見された場合、また、本文書の使用により付随的または間接的に生じる損害について一切責任をさせていただきます。


アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2023
Published in Japan, October 16, 2023

DE37633235

 **Agilent**
Trusted Answers


最新バージョンにアップグレードする理由① — 積分最適化ウィザード

- ・ 視覚的な3つのステップ操作だけで、目的ピークのみを簡単に積分
- ・ 積分条件の決定に要する時間を大幅に短縮
- ・ ChemStationの自動積分を、さらに使いやすくした機能

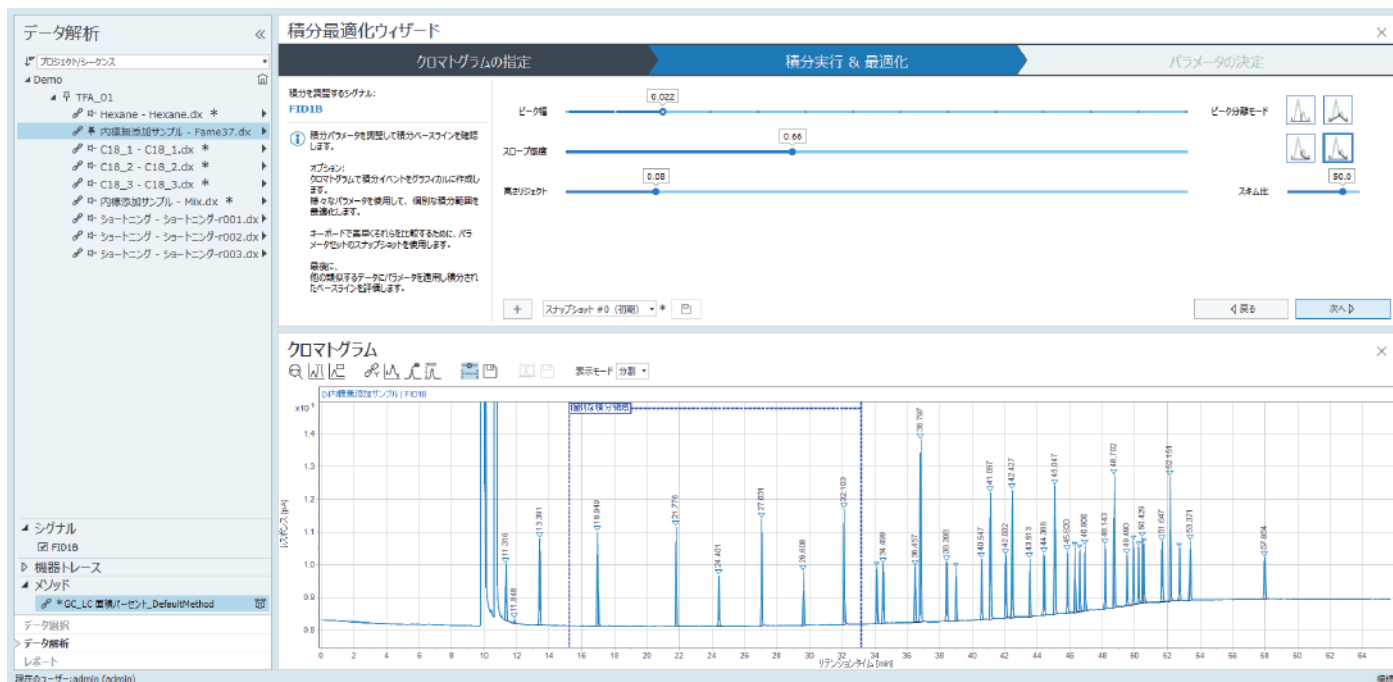

最新バージョンにアップグレードする理由② — マルチベンダーコントロール

- ・ 測定画面の [機器ステータス] と [測定メソッド] は、接続装置によって画面が変化
- ・ そのほかの操作 (シーケンス、解析、レポートなど) は、どの装置メーカーでも同じ
- ・ 既存の他社装置も OpenLab CDS 2 で一緒に制御可能

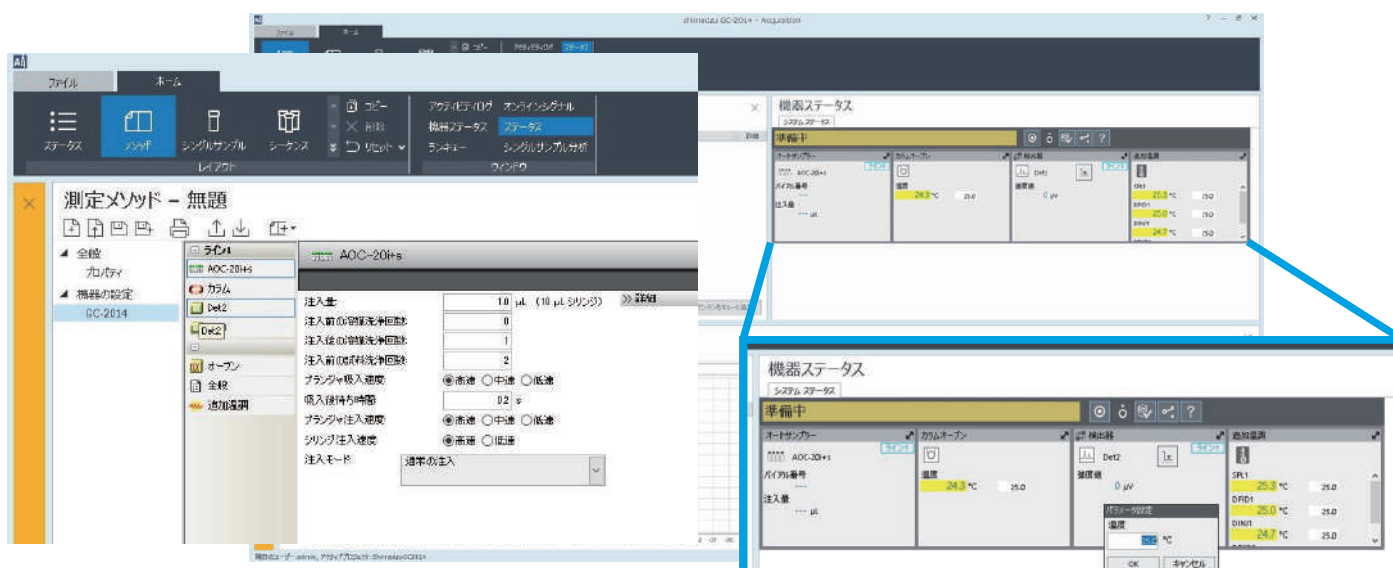

本資料掲載の製品は、すべて研究用です。本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。アジレントは、本文書に誤りが発見された場合、また、本文書の使用により付随的または間接的に生じる損害について一切免責とさせていただきます。